

マイコン電気炉 M-D1 HT

目 次

頁


1. 各部の名称・仕様	2
2. 時計セット	3
3. 電気炉の一般使用法	3
4. モード『1』について	4
5. モード『2』について	4
6. モード『3』について	4
7. プログラムタイマーの使用法	5
8. 応用 (700°C ⇒ 800°Cへ変更)	5
9. エラーメッセージの表示について	6
10. 各トリマー変更	7

この度M-D1 HT型高温マイコン電気炉のご採用頂き、有り難うござい
ます。我社では、一人でも多くのユーザー様に簡単にご愛用頂ける様、
日々研究開発いたしておりますが、ご使用前に必ず本説明書をお読み頂
きます様お願い申し上げます。

本機はマイクロコンピューターを採用しており、ホコリを特に嫌います
できる限り、環境衛生にご努力下さいます様、お願い申し上げます。

信頼のマーク
Angel


| 各部の名称

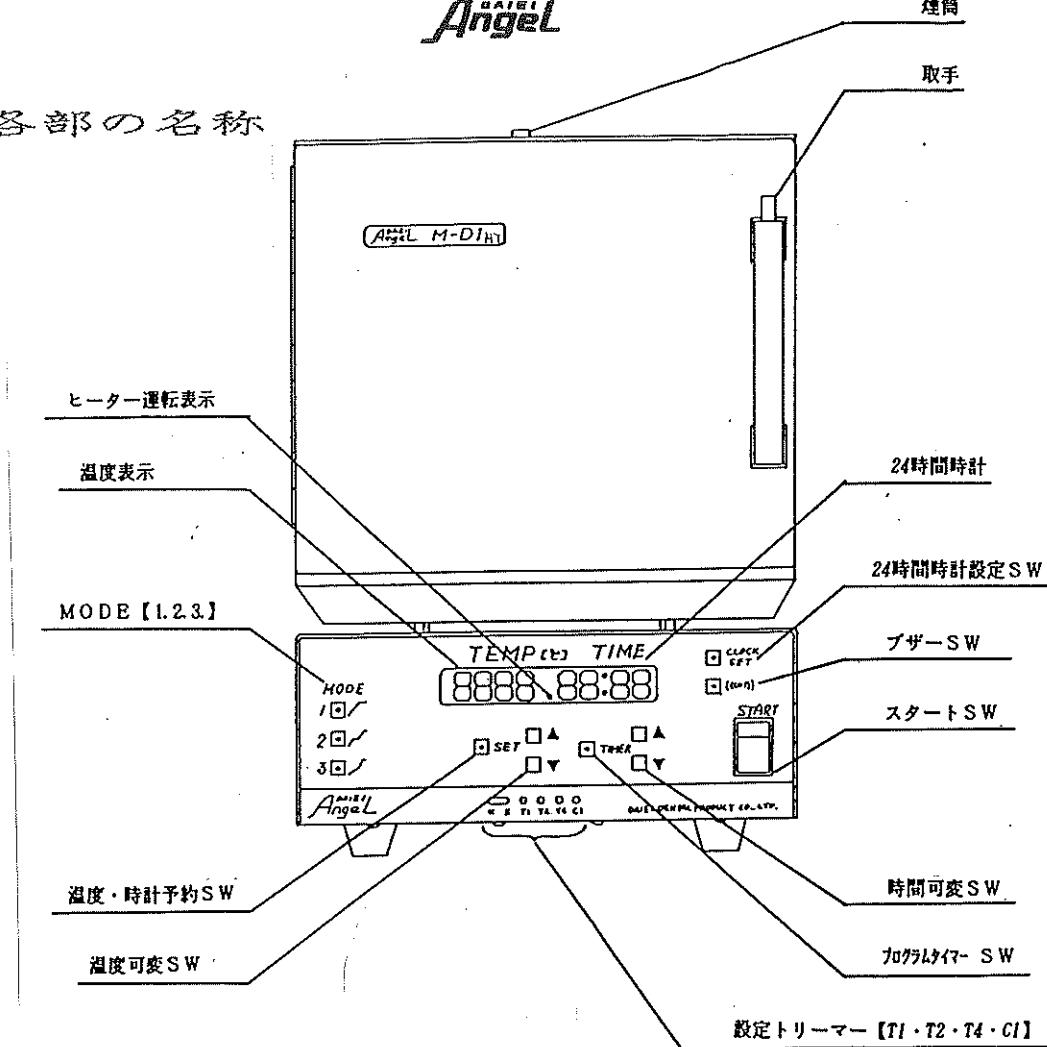

仕様

最高温度	1200°C	本体寸法	W285×H400×D400mm	温度計	デジタル(5°C刻み)
常用温度	1100°C	炉内寸法	W140×H110×D200mm	時計	デジタル(24時間計)
温度誤差	±10°C	所要電力	AC100V 1400W	警報装置	各種エラーメッセージ表示
重量	19.0kg	温度制御	マイコン制御	外部コンセント	冷却ファン用

| 各部の名称

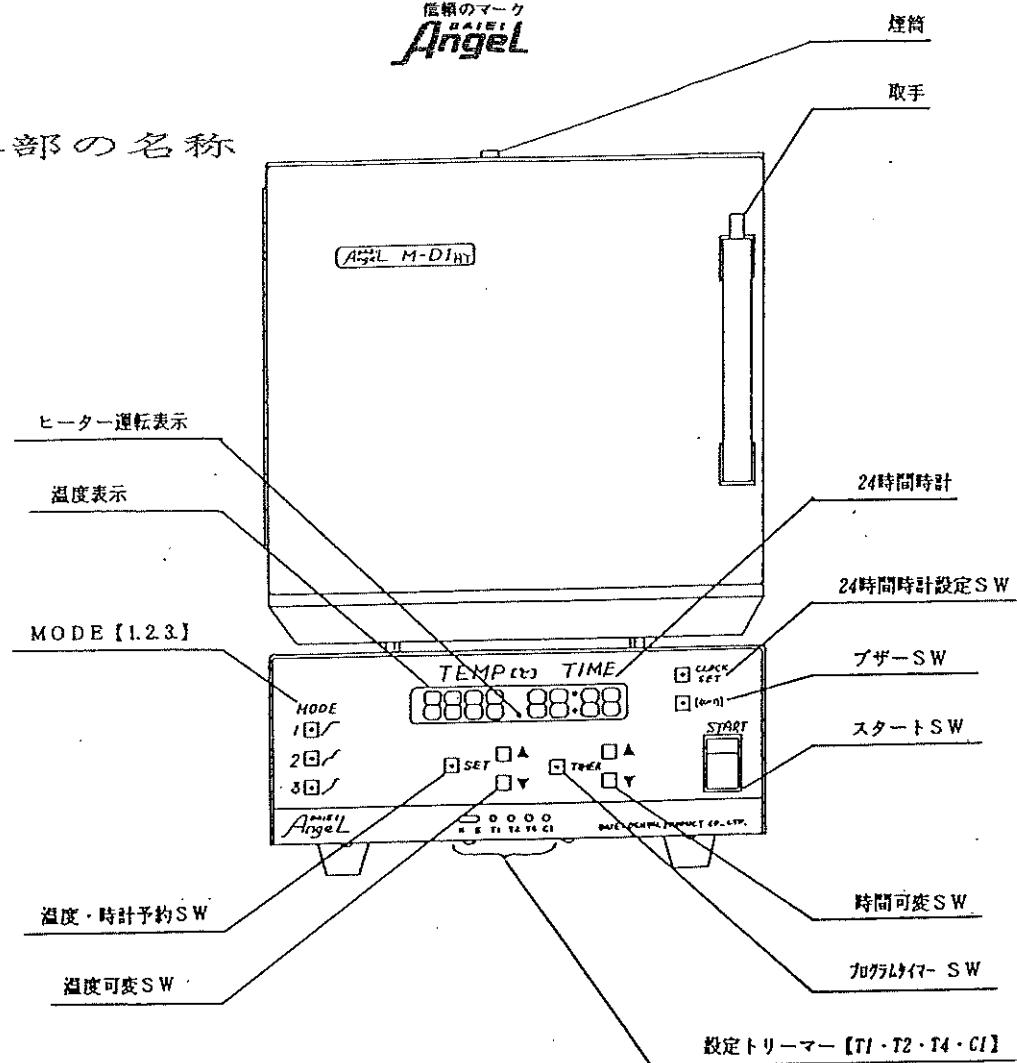

仕様

最高温度	1200°C	本体寸法	W285×H400×D400 mm	温度計	デジタル(5°C刻み)
常用温度	1100°C	炉内寸法	W140×H110×D200 mm	時計	デジタル(24時間計)
温度誤差	±10°C	所要電力	AC100V 1400W	警報装置	各種エラーメッセージ表示
重量	19.0kg	温度制御	マイコン制御	外部エント	冷却ファン用

2. 時計セット

①電気炉の電源コンセントを入れる。

本機の電源はAC100V(15A以上のコンセント必要)で作動します。

AC100V以外の電源を使用しないで下さい。

電気炉のヒーター回路を除く部分(コントローラー部)の電源が入ります。

この時、TEMP及びTIMEは0000を表示します。

(但し、出荷点検の関係で既に現在の時刻を設定している場合があります。)

②現在の時刻の設定

*【CLOCKSET】SWを押します。(現在時刻設定モードとなり、
【CLOCKSET】ランプが点灯します。)

*【▲】SW又は【▼】SWにより時刻を合わせ、合った所で【CLOCKSET】SWをもう一度押せば時計が作動し始めます。

(但し、時刻表示は24時間計です。午前・午後に気を付けて下さい。)

3. 電気炉の一般使用法

*【SET】SWを押します。(最終温度及び、作動開始の設定モードとなり
【SET】ランプが点灯します。)

この時、温度表示及び、時計表示は、現在値から設定値に変わります。

*TENPの【▲】SW又は【▼】SWにより最終焼却温度を設定します。

*【SET】SWをもう一度押して、設定を記憶させます。

*3つのモードのいずれかを選択すると、選択されたSWのランプが点灯します。(各モードについては次ページを参考にして下さい。)

*ブザー【((●))】SW・【START】SWを押して、本機を作動させます
昇温中ヒーター運転表示ランプは点滅しますが、異常ではありません。

バックアップについて

本機の使用には24時間、電源を入れておく事を基本とします。

夜、電源を抜かれる方の為に、本機は与えられたデーター及び現在の時刻の記憶保護としてバックアップ電池(充電式ニカド電池)を内蔵しております。

バックアップ電池は充電式で一度充電(約10時間)すると約20日間記憶を保護しています記憶が解除された場合は、1-②(現在の時刻の設定)及び、
2-①(最終焼却温度の設定)を再度行ってください。

4. モード『1』について（図1参考）

MODE 1は本機のフルパワー（1400W）で作動し、最終温度で30分間係留後、ブザーが鳴ります。（ブザー【((●))】SWを切っても、係留は継続します）
＊焼却リングの数が少ない時や、リングが小さい時、又速い焼却を希望する時に御利用下さい。

参考

昇温速度：カラ焼き 常温から1100℃迄、70分

5. モード『2』について（図2参考）

MODE 2は二段係留を目的に設計された昇温をします。

図2中のC1・T2・T4は予め記憶されています。

記憶されているトリマー

C1	400℃
T2	30分
T4	30分

本機は歯科用埋没材を全般的に検討した結果、左記の条件を決定しております。変更を希望される方は、P7（各トリマーの変更）をご覧下さい。

6. モード『3』について（図3参考）


MODE 3はエンゼル歯科用電気炉のオリジナル昇温です。

図3中のC1・T1・T4は予め記憶されています。

記憶されているトリマー

C1	400℃
T1	60分
T4	30分

本機は、現在時間から60分間、マイコン制御が作動します。スタートして約2分間は昇温ランプが点燈しませんが、異常ではありません。

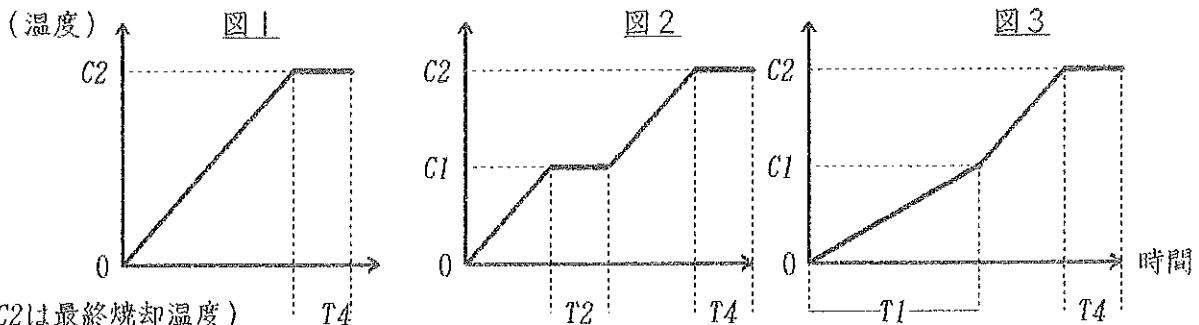

7. プログラムタイマーの使用法

- * 【SET】SWを押します。（最終焼却温度及び、作動開始の設定モードとなり【SET】ランプが点灯します。）
この時、温度表示及び、時計表示は、現在値から設定値に変わります。
- * TIMEの【▲】SW又は【▼】SWにより作動開始時刻を設定します。
- * 【SET】SWをもう一度押して、設定を記憶させます。
(本時計は24時間計です。設定には時刻を間違わないようお願いします)

時刻設定（例）	
午前7時	7:00
午後7時	19:00

- * 3つのモードのいずれかを選択すると、選択されたSWのランプが点灯します。（各モードについてはP3を参考にして下さい。）
- * 【TIMER】SWを押し、ランプが点灯している時に、【START】SWを押すと【START】SWが自照し、上記で設定された作動開始時刻に電気炉のヒーター回路の電源が入り、各動作モードの運転を開始します。
- * 炉の運転中に【SET】SWを押せばその間、現在記憶している最終焼却温度及び、開始時刻を確認することができます。
- * 電気炉へ通電している間は、ヒーター運転表示ランプが点灯します。
- (注意) いずれのモードの選択なしで、タイマーセットはできません。

8. 応用

石膏系埋没材（700°C）の鋳造後、リン酸塩系埋没材（800°C）を鋳造する場合
(各モード共通)

- * 700°Cで鋳造後、【START】SWを切る。
- * 【SET】SWを押し、TEMPの【▲】SW又は【▼】SWにより最終焼却温度を800°Cに設定しなおす。
- * 再度【SET】SWを押して、設定を記憶せざる。
- * MODE1を選択して【START】SW・ブザー【((●))】SWを押す。
以上で800°C30分係留の後（ブザーが知らせる）リン酸塩系埋没材の鋳造ができる状態になります。

9. エラーメッセージの表示について

各エラーが生じた場合、温度表示が次の表示に変わり、警告ブザーが鳴ります。

	表示	原因	対応
操作表示	7000	いずれのモードの設定なしにスタートさせた。	【START】SWを切る。 MODEの設定からやり直す。
	7100	現在時刻設定中にスタートさせた。	【START】SWを切る。 現在時刻の設定を続行・終了。
	7200	最終焼却温度・作動開始時刻を設定中にスタートさせた。	【START】SWを切る。 温度・時刻の設定を続行・終了
温度設定表示	8000	最終温度が現在温度よりも、低く設定され、スタートした	【START】SWを切る。 最終焼却温度の設定をやり直す
	8100	最終焼却温度が50°C以下に設定され、スタートさせた。	【START】SWを切る。 最終焼却温度の設定をやり直す
	8200	中間係留温度が現在温度よりも低い時、スタートさせた。	モード2・3⇒モード1変更 又は、電気炉の冷却を待つ。
	8300	最終温度が中間係留温度よりも低い時、スタートさせた。	【START】SWを切る。 最終焼却温度の設定をやり直す
故障	9000	温度センサーの断線	温度センサー（熱電対）の交換
	9100	ヒーター線回路の断線	ヒーターの交換
	9200	炉の運転中1250°C越えた時	炉の冷却を待つ。要修理

10. 各トリマーの変更(付属小ドライバーを使用)

【T1】・【T2】・【T4】・【C1】トリマーの設定変更について。

*制御器、前面(中央下部)の設定トリマーのスライドSWをS側に切り変えます。(通常及び設定終了後N側にする事)

【T4】・【C1】の設定変更

*【MODE1】SWを押す。【MODE1】ランプが点灯し、前面時刻表示部に【T4】の設定値、温度表示部に【C1】の設定値が表示され点滅。

この時【T4】及び【C1】を前面中央下部のトリマーによって設定変更する

【T2】・【C1】の設定変更

*【MODE2】SWを押す。【MODE2】ランプが点灯し、前面時刻表示部に【T2】の設定値、温度表示部に【C1】の設定値が表示され点滅。

この時【T2】及び【C1】を前面中央下部のトリマーによって設定変更する

【T1】・【C1】の設定変更

*【MODE3】SWを押す。【MODE3】ランプが点灯し、前面時刻表示部に【T1】の設定値、温度表示部に【C1】の設定値が表示され点滅。

この時【T1】及び【C1】を前面中央下部のトリマーによって設定変更する

各トリマー設定変更後、スライドSWをN側に戻せば、現在時刻及び現在温度に表示が変わり、通常の動作に戻ります。

—【T1】・【T2】・【T4】・【C1】の変更可能範囲—

【T1】	30～180分
【T2】	30～180分
【T4】	0～60分
【C1】	200～510℃

ご使用上、何かご質問がございましたら下記まで、ご連絡下さい。

大榮歯科産業株式会社 本社 機械開発部 ☎ 06-441-3332 (代)